


LICHEN

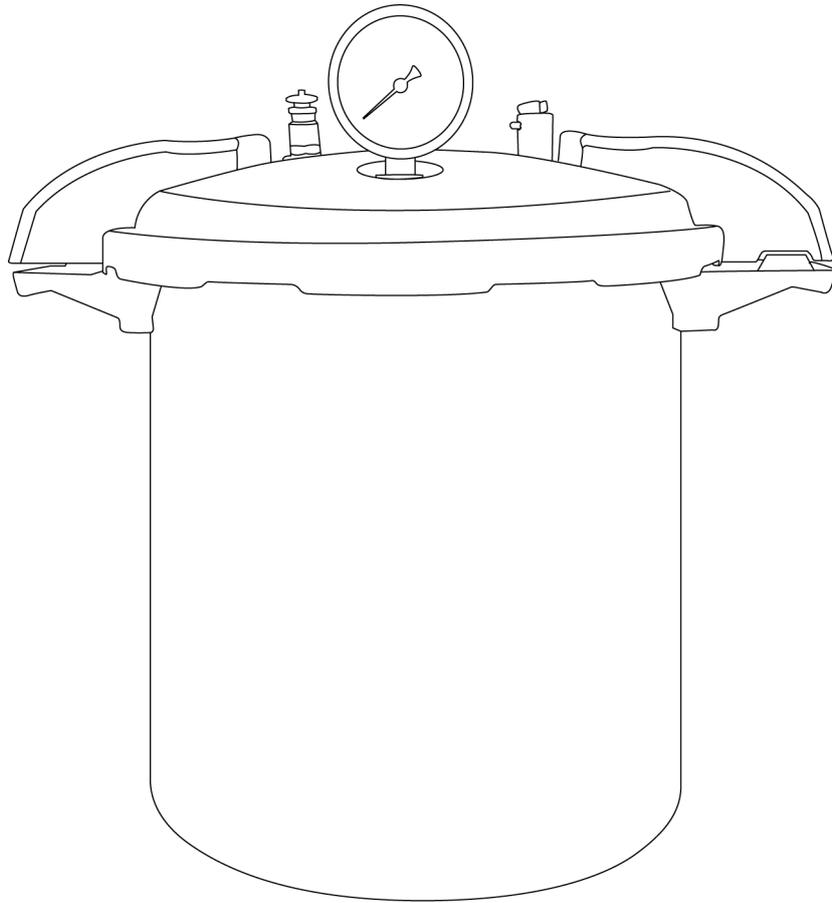

使用说明

快开手提式高压蒸汽灭菌器

USER' S INSTRUCTIONS

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

目录

前言	1
一、概述	2
二、结构	2
三、产品特点	2
四、产品参数	3
五、设备安装	3
六、设备使用	3
七、维护保养	4
八、故障分析	4
九、保修声明	5
十、开箱检查	5
十一、装箱清单	5

前言

感谢您选择力辰科技 QPS 系列快开手提式高压蒸汽灭菌器，为获得更好的使用体验，请认真阅读本使用说明书，并遵守安全操作规范！

请妥善保管本使用说明书以便需要时查阅！

危险！

- 请确保只有受过相关训练的人员才能操作使用本仪器。
- 请遵守安全规范、人身安全和事故防止等相关规范。
- 切勿用湿手去插拔电源插头。
- 为防止触电事故，灭菌器操作人员在装卸被灭菌物时应先切断电源。
- 灭菌器内蒸汽未放尽时切勿开启器盖，以防发生蒸汽灼伤事故。
- 注意！灭菌器在工作过程中，会产生 120℃ 以上的高温，切忌肌肤直接接触灭菌器金属部位，谨防烫伤！
- 使用过程中操作人员切勿离开操作现场！
- 严禁超压使用，如果超压使用将有可能发生爆炸事故。


警告！

- 请使用独立的有保护接地的三孔 220V/10A 电源插座，并确认保护接地端子已可靠连接。
- 请将灭菌器电源插头完全地插入电源插座中，请不要使用指定以外的电源。
- 本灭菌器不适用于密封性液体、不耐高温高压物品的灭菌。请勿灭菌易燃、易爆、腐蚀性物品。
- 不得随意拆卸和调整仪器的零部件，备件损坏时，请仅使用原装备件进行更换。
- 设备发生故障时，应及时切断电源，并在第一时间联系我司进行维修指导或返厂检修。
- 灭菌包裹（或产品）应附有化学指示剂（管），以便查看灭菌状态。
- 请不要在灭菌器上放置任何东西。
- 设备不要放置在靠近热源的地方。
- 不可损毁、修改、拉拽、过度弯曲或扭曲电源线，亦切勿把重物置于电源线上。
- 请将仪器放置于平稳、清洁、防滑、干燥和防火的台面。

一、概述

快开手提式高压蒸汽灭菌器采用饱和蒸汽进行消毒灭菌，具有灭菌效果好，无污染、残留物等特点，是一种小巧轻便，操作简单，安全高效的小型消毒灭菌设备，供教学、科研、农业等单位使用，本产品为非医疗器械产品。

二、结构

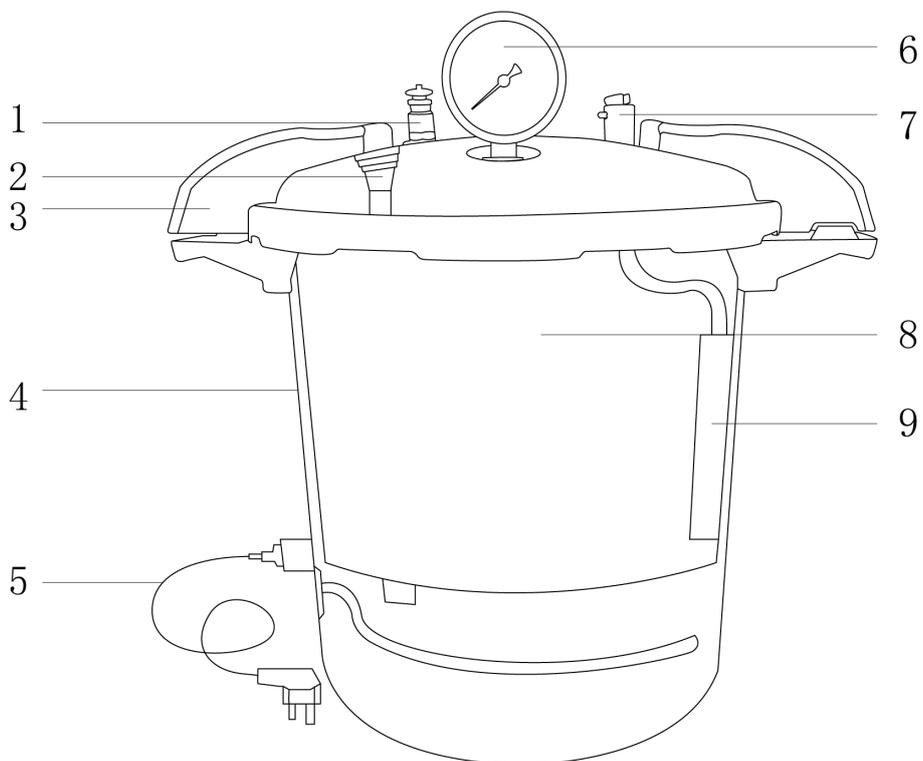

- | | | |
|-------|--------|--------|
| 1、安全阀 | 2、安全联锁 | 3、手柄 |
| 4、外桶 | 5、电源线 | 6、压力表 |
| 7、放汽阀 | 8、置物内桶 | 9、排汽软管 |

三、产品特点

- 1、采用快开式结构，开盖方便不费力；
- 2、采用防干烧加热管，升温迅速，节能高效；
- 3、带有双刻度压力表，压力表指针指示清晰，观察方便，性能可靠；
- 4、安全联锁防止蒸汽泄漏和意外伤害。安全阀、放气阀、超压自泄保证安全；
- 5、无底座设计减少了占地面积，适合在空间有限的场所使用。

四、产品参数

产品型号	LC-QPS-12E	LC-QPS-18E	LC-QPS-24E
电源电压	220V/50Hz		
功率	2KW		
容积	12L	18L	24L
额定工作压力	0.142MPa		
额定工作温度	126℃		
最高工作压力	0.165MPa		
内桶尺寸 (Φ×H)	Φ 280×135mm	Φ 280×240mm	Φ 280×335mm
净重	10Kg	11Kg	12.5Kg
产品尺寸 (Φ×H)	Φ 340×330mm	Φ 340×430mm	Φ 340×530mm

五、设备安装

1、工作环境的选择

应按下面的要求选择工作环境：

环境温度范围：5℃～40℃；

相对湿度范围：不大于 85%；

使用电源：220V±22V，50Hz±1Hz。

(1) 将仪器放置于平整、清洁、防滑的台面上；

(2) 远离高速尘源和震源。

2、设备安装

(1) 打开包装，检查设备是否完整无损，配件是否齐全；

(2) 将仪器放置在台面上。

六、设备使用

1. 操作方式

(1) 加水

把内桶从外桶中取出后，在外桶内加入清水，所加水位必须至内桶支架位置。

(2) 放置内筒、蒸板、带菌器械和器皿等

将待灭菌物品用清洁白布包扎好，然后顺序码放在储物桶内的蒸板上，各包之间应留有一定的间隙，以利于蒸汽通过，提高灭菌效果。

(3) 放置波纹管、密封上盖

将待灭菌物品码放好后，把器盖上的波纹管插入内桶格栅内，然后盖上器盖。

(4) 打开放汽阀

将放汽阀扳至竖直位置，打开放汽阀，待蒸汽溢出比较急切时关闭。

(5) 通电加热灭菌

①设备通电

将电源插头插入电源插座内，接通电源，对设备进行通电。

②加热

将放汽阀扳至水平位置将其关闭。此后灭菌器内压力、温度将随着加热时间的延长逐步升高。

③灭菌

当灭菌器内压力、温度到达所需要的灭菌条件时，即可开始计时进行灭菌。

④灭菌完成

灭菌结束后，拔下电源插头，切断电源停止加热。

(6) 冷却

当灭菌瓶装液体或袋装液体时，灭菌结束后，切勿立即排放灭菌器内蒸汽，否则，高温液体压力突然下降，会发生瓶内液体迅速沸腾汽化，而发生液体溢出、爆瓶、爆袋现象，甚至引发灭菌器爆炸事故。因此液体灭菌结束时，应首先拔下电源插头，切断电源停止加热。使其自然冷却至压力表指针回到零位后，再延迟 1~2 分钟，打开放汽阀排尽余汽，才能开启器盖。

七、维护保养

- 1、设备密封性能应该及时检查；
- 2、设备停用一个月以上需要重新使用时，应检查安全阀是否正常使用；
- 3、应该经常检查“上盖”密封圈有无局部脱落现象，一旦发现应及时将密封圈嵌入槽内，以免防止设备在加热升压过程中因密封圈弹出使设备突然泄压而发生意外；
- 4、更换密封圈时应打开灭菌器上盖，沿着盖内侧弧形槽，将密封圈取出后，再将新的密封圈装入，并检查其密封性；
- 5、使用前用清水常规冲洗即可，擦干存放；
- 6、贮存在无腐蚀性气体和通风良好的清洁室内。

八、故障分析

故障现象	原因分析	解决办法
插上电源后不通电	电源线损坏	进行更换
	插头损坏	进行更换
电热管不升温	电源没有连接好	检查电源插头
	电热管已经损坏	及时进行更换
灭菌器漏气	密封圈老化	及时进行更换
	安全阀损坏	及时进行更换
	放汽阀损坏	及时进行更换
安全阀不工作	安全阀损坏	及时进行更换
压力表指针不归零	压力表故障	及时进行更换
压力表漏气，有水珠	压力表故障	及时进行更换

九、保修声明

本公司产品保修期一年（从产品售出之日起）。保修期内，用户可凭保修卡、商业发票对质量有问题的产品实行更换或免费维修。属下列情况之一除外：

- 1、保修期已过；
- 2、因用户自己的过失而造成仪器的损坏；
- 3、用户未按说明书规定操作而造成仪器损坏；
- 4、由于仪器暴露在具有放射性或腐蚀性物质的环境中造成仪器损坏；
- 5、用户擅自拆开仪器或非经上海力辰邦西仪器科技有限公司认可的维修人员修理、调试而造成仪器的损坏。

十、开箱检查

请小心拆开包装，并对照本说明书附录装箱单，对仪器各部件进行清点、检查。如发现有任何破损，请及时联系我司。

十一、装箱清单

序号	名称	数量
1	手提式压力蒸汽灭菌器	1 台
2	电源线	1 根
3	内桶	1 个
4	筛板	1 个
5	使用说明书	1 份
6	合格证/保修卡	1 份

LICHEN

上海力辰邦西仪器科技有限公司

Shanghai Lichen-BX Instrument Technology Co.,Ltd.

地址:上海市松江区三浜路 469 号 9 幢

联系方式 400-840-9177

网站:www.lichenl7.com

本资料内容如有变更,恕不另行通知

最终解释权归本公司所有